

# CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE RELÓGIO COMPARADOR

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

<b>Patrimônio</b>	<b>Número de ordem</b>

## INSTRUMENTO

Descrição:	
Fabricante:	
Código:	

Resolução:	
Faixa de indicação:	
Lotação:	

Instrução utilizada:	
Temperatura =	Umidade relativa =


## SISTEMA DE MEDIÇÃO PADRÃO

DESCRIÇÃO	CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO N°	DATA	PROCEDÊNCIA

## RESULTADOS

SMC (mm)	$E_{m\acute{a}x}$	
	AVANÇO ERRO DE INDICAÇÃO E (µm)	RETORNO ERRO DE INDICAÇÃO E (µm)
0,0		
0,5		
1,0		
1,5		
2,0		
2,5		
3,0		
3,5		
4,0		
4,5		
5,0		
5,5		
6,0		
6,5		
7,0		
7,5		
8,0		
8,5		
9,0		
9,5		
10,0		
$E_{m\acute{a}x} =$		

## CURVA DE ERROS

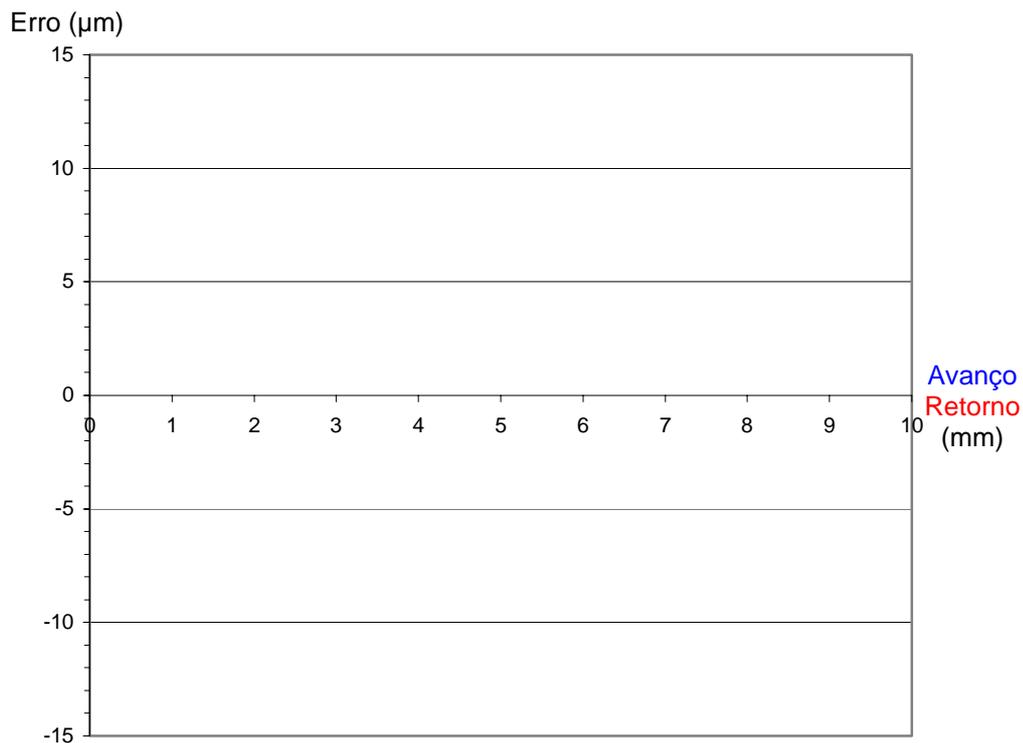

## CONCLUSÃO

	VALOR ADMISSÍVEL	VALOR ENCONTRADO	AVALIAÇÃO
ERRO MÁXIMO			
ERRO MÁXIMO EM 2 mm			

### CALIBRAÇÃO FEITA POR:

Este certificado é válido exclusivamente para o objeto calibrado descrito nas condições específicas, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo que similares.  
Não é permitida a reprodução deste certificado.